

UTI192M 测试报告

环境温度：23.3℃/65%

一、检测项目：测量功能。


二、检测设备（主要）：

FULKE4080/4181/M1200(发射率：0.95/0.99)口径15cm/5.5cm,距离1米

三、检测范围：-20℃到650℃

四、测温表格：

设定温度 (°C)	测试温度 (°C)
-20	-18.7
-10	-10.8
0	0.6
30	30.7
50	49.8
60	60.6
90	90.2
100	99.5
150	151.9
300	308.3
450	451.2
650	648.5

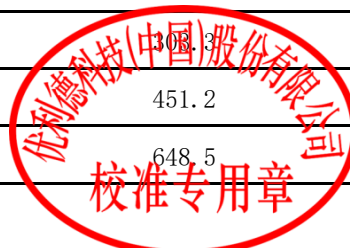

检查员：刘爱

审核员：郭桂余