

UTI380H QA测试报告

环境温湿度: 24.3°C/65%

一、检测项目: 测量功能。

二、检测设备(主要):


a) 高温黑体ES1000 (温度范围: 50~1000°C; 发射率: ≤ 0.99)

b) 精密黑体CES100 (温度范围: -20~100°C; 发射率: 0.97 ± 0.02)

四、检测范围: -20°C到300°C

五、测温表格

设定温度 (°C)	测试温度 (°C)
-20	-19.8
0	0.6
30	30
60	60
90	90.2
120	119.9
140	139.8
180	179.7
250	249.9
300	300.0

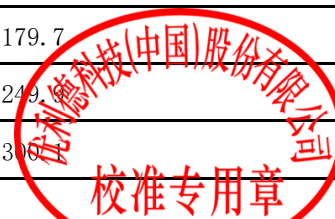

检验员: 吕丽霞

审核员: 郭桂余