


## UT305S 测试报告

使用设备:FLUKE9133、4081、KSDZ-1200

环境温湿度:23.2℃/60%

功能	测试值	单位	输入	准确度	读数范围	测试距离	测试值	测试结果
温度及 激光	-10℃~ 1200℃	℃	-10.0	±3℃	-13~-7℃	5CM	-11.2℃	合格
		℃	0.0		-3~3℃	5CM	-0.8℃	合格
		℃	50.0	±1%或1度取 最大值	49.0~51.0℃	50CM	50.2℃	合格
		℃	100.0		99.0~101.0℃	50CM	100.1℃	合格
		℃	350.0		346.5~358.5℃	50CM	350.7℃	合格
		℃	450.0		445.5~454.5	50CM	449.5℃	合格
		℃	600.0		594.0~606.0℃	50CM	603.4℃	合格
		℃	1200.0		1188~1212℃	50CM	1208℃	合格

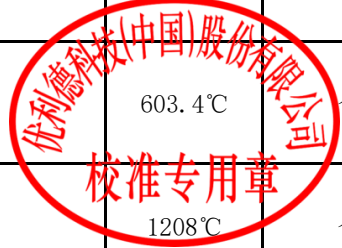

检测员: 刘爱

审核员: 郭桂余