


**LM100A QA检测报告**

测试仪器：测距轨道

环境温度为 25.3 °C, 湿度为 57 %

单位M	最小误差	最大误差	测度值	测度值	测度值
0.20	0.198	0.202	0.198	0.198	0.199
1.00	0.998	1.002	1.000	1.000	1.000
2.00	1.998	2.002	2.000	2.000	2.002
5.00	4.998	5.002	5.002	4.998	5.002
10.00	9.998	10.002	10.001	9.999	10.001
15.00	14.998	15.002	15.000	15.001	15.001
20.00	19.997	20.003	20.001	19.998	20.001

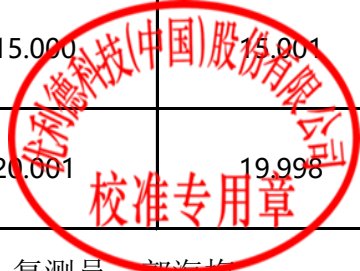

测试员：刘爱

复测员：郭海梅